

# IRON MAN 3™ STARBOOST

1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE MMS214

INSTRUCTIONS SHEET




## G. DYNAMIC FIGURE STAND 特製台座について

Don't bend or twist the pillar with excessive force; otherwise, it will be damaged.  
強引に曲げる・ねじるなど、フレキシブル・ピラーに過度な力を加えると、破損につながります。




Attach the flexible pillar and the figure holding clip to the base. フレキシブル・ピラーヘフィギュアを固定するクリップをセットし、特製台座へ取り付けます。

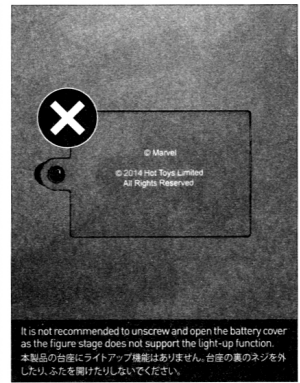

© 2014 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.  
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp


## A. LED LIGHT-UP EYES 目のライトアップ機能について

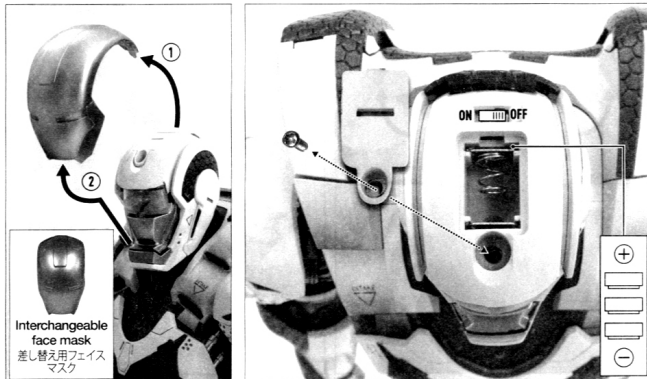

Detach the top of the helmet as shown. 画像を参考に、ヘルメットの上部を取り外します。

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by turning the on/off switch. 製品には電池 (AG1/LR621) が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。


## B. LED LIGHT-UP MICRO ARC REACTOR ON CHEST 胸部のアーキ・リアクターについて

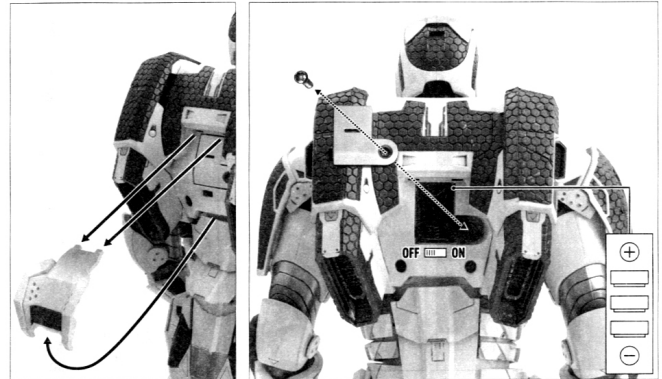

Detach the back armor as shown. 画像を参考に、背中のアーマーを取り外します。

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG9/LR936, 1.5V) are included. Activate the light-up function by turning the on/off switch. 製品には電池 (AG9/LR936) が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。


## C. ARMS WITH REPULSOR LIGHT-UP FUNCTION 両腕のリパルサー (ライトアップ機能対応) について

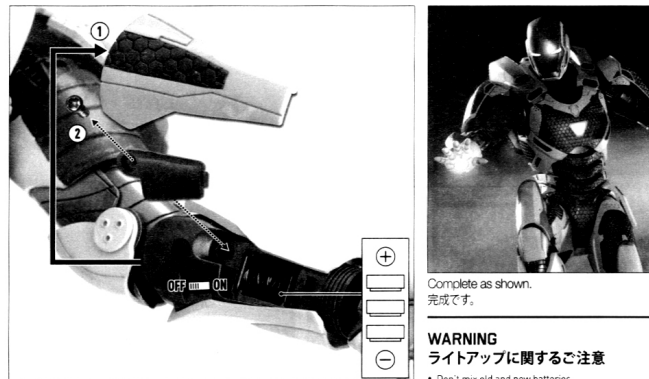

Take off the armor plate. Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by turning the on/off switch. 画像を参考に、腕のアーマーパーツを取り外します。製品には電池 (AG1/LR621) が付属します。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。

Complete as shown. 完成です。


## D. EXTENDED SHOULDER MOVEMENT 肩部の可動について

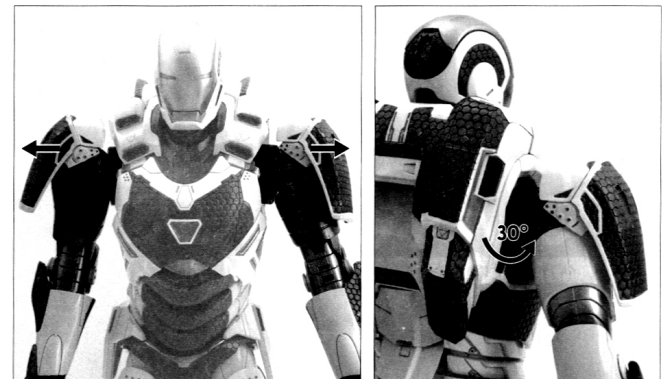

Slightly pull out the shoulder. 画像を参考に、肩部を少し引き出してください。


Now the shoulder can be moved forward within 30°. 肩部は内側へ30度まで動かせます。

## E. WAIST MOVEMENT 腰部の可動について

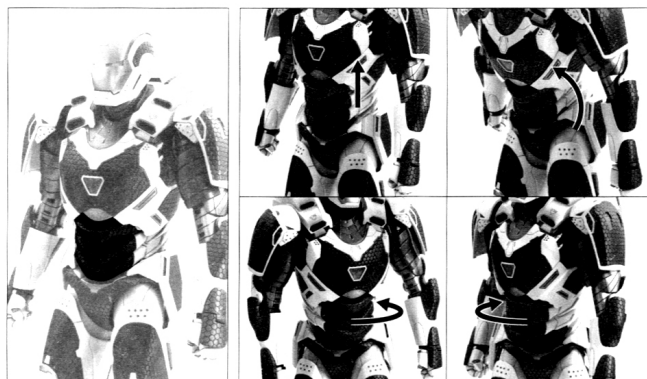

Extend the waist by pulling up the upper body. It can now be moved to the preferred position within 45°. 腰を可動させる際は、下半身を固定し上半身を引き上げてから、曲げた方向へ動かしてください。(可動範囲は45度以内です。)

## F. LEG MOVEMENT 脚部の可動について

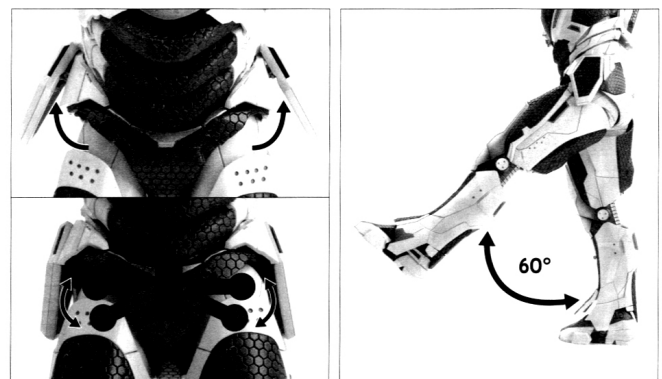

The flaps will push up automatically when moving the legs. It is suggested to extend the legs by pulling them down slightly for easier positioning. 脚を動かすと、腰部のフラップは運動して押し上がります。脚を可動させる際は、画像のように左右それぞれ少し引き下げてから行ってください。

The legs can be raised within 60°. 脚は上下に60度まで動かせます。